

TEST KIT TOTEM*

Analisi del Disinfettante (REVACIL) e del pH

- Per prudenza, controllare la concentrazione di disinfettante **REVACIL** nella piscina, ogni settimana, per aggiustare se necessario.


Metodo di utilizzazione

Disinfettante

1. Riempire con acqua di piscina il tubo « D » fino alla riga nera
2. Aggiungere **6** gocce di reagente disinfettante – Tappare e agitare per mescolare
3. Togliere il tappo e mettere il tubo nello spazio rotondo
4. Riempire con acqua di piscina il secondo tubo fino alla riga, e metterlo nello spazio quadrato
5. Orientare il riflettore bianco verso la luce
6. Girando la ruota in plastico, selezionare il colore o l'intervallo di colore-campione corrispondente al colore della provetta.
7. Se il colore della provetta è :
 - Compresa tra la posizione 3 e 4 : il disinfettante è correttamente dosato
 - Vicino alla posizione 2 : aggiungere 0,1 L di disinfettante per 10 m³ d'acqua di piscina
 - Vicino alla posizione 0 : aggiungere 0,3 L di disinfettante per 10 m³ d'acqua di piscina
 - Vicino alla posizione 6 : c'è sovradosaggio, aspettare che il prodotto si consumi.

PH

1. Riempire con acqua di piscina il tubo « pH » fino alla riga nera
2. Aggiungere **6** gocce di reagente « pH » - Tappare e agitare per mescolare.
3. Togliere il tappo e mettere il tubo nello spazio rotondo
4. Riempire con acqua di piscina il secondo tubo fino alla riga e metterlo nello spazio quadrato
5. Orientare il riflettore bianco verso la luce
6. Girando la ruota in plastico, selezionare il colore o l'intervallo di colore-campione corrispondente al colore della provetta
7. Se il colore della provetta non è nella zona ideale, secondo la qualità dell'acqua, aggiungere **REVA-MINUS** per abbassare il pH o **REVA-PLUS** per aumentare il pH.

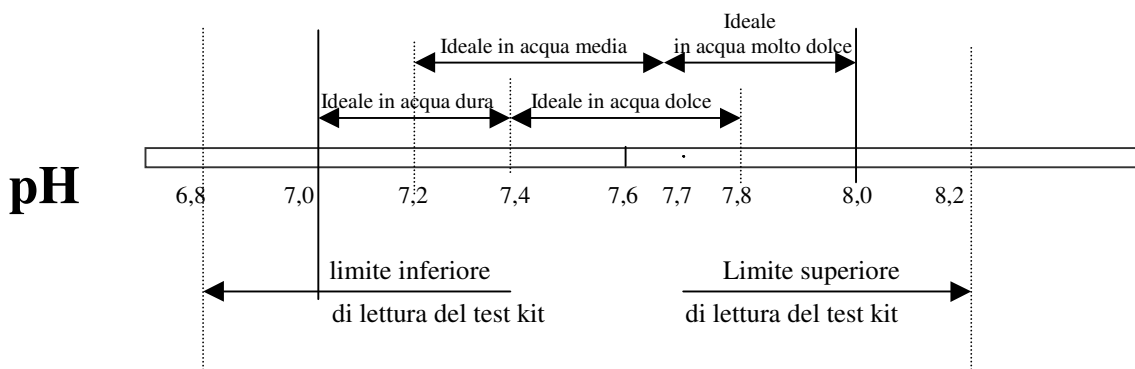

Attenzione! Se ottenete valori equivalenti a 6,8 e 8,2+, il pH dell'acqua può essere molto più basso o molto più alto del valore indicato dal reagente ; per tornare al valore normale, può essere necessaria una quantità maggiore di **REVA-MINUS** o di **REVA-PLUS**.

Precauzioni

- ◆ Attenzione di non inversare i tappi dei tubi per non mescolare i reagenti
- ◆ Per versare le gocce di reagente, tenere la bottiglia verticale per ottenere gocce uniformi
- ◆ Per vedere bene i colori, fare i dosaggi nella luce del sole
- ◆ Cambiare i reagenti ogni anno
- ◆ Sciacquare i tubi dopo ogni utilizzazione.

Mantenimento

- Riempire i tubi fino alla metà con acqua e aggiungere **6** gocce d'acido (tappo bianco).
- Pulire con lo scovolino
- Poi, sciacquare bene.

Sicurezza

I reagenti non presentano pericoli particolari. Per precauzione, si consiglia di :

- ◆ Conservare fuori della portata dei bambini
- ◆ Per evitare ogni ingestione accidentale, non mangiare, fumare o bere durante l'utilizzazione.

* fino ad esaurimento

DURATA DI CONSERVAZIONE DEI REAGENTI : 5 ANNI

200007

Informazioni tecniche fornite senza garanzia contrattuale.

Mareva - La Piscina Gioiosa